Cochlear®
Hear now. And always

Hurtigveiledning for MFi-tilkobling

Cochlear™ Baha® 6 Max

Fordeler ved tilkobling direkte til enhet med Made for iPhone (MFi)

- **Trådløs overføring av musikk eller annen lyd** fra apper direkte til lydprosessoren
- **Trådløs overføring av telefon- eller FaceTime-samtaler** direkte til lydprosessoren
- **Velg innstillinger** på lydprosessoren
- Bruk en Apple-enhet som **ekstern mikrofon**
- Bruk **Cochlear™ Baha® Smart-appen**

Made for
iPhone | iPad | iPod

Kompatibilitet

Baha 6 Max er en Made for iPhone lydprosessor.

For oppdatert informasjon om kompatibilitet, se www.cochlear.com/compatibility

Paring og tilkobling av lydprosessoren

1. Slå på **Bluetooth** på Apple-enheten (figur 1).
2. Gå til **Innstillinger > Tilgjengelighet** (figur 2).

figur 1

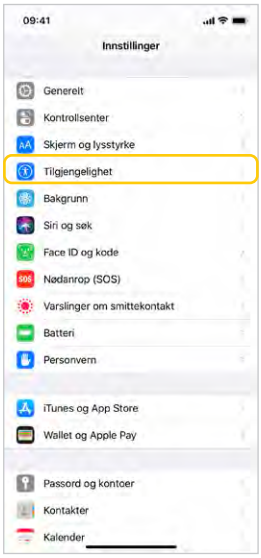

figur 2

Hurtigveiledning for MFi-tilkobling

Cochlear™ Baha® 6 Max

Paring og tilkobling av lydprosessoren

3. Start lydprosessoren på nytt ved å åpne og lukke batteriluken (figur 3).
4. Velg **Høreapparater** under **menyen Tilgjengelighet** (figur 4).
5. Du vil se lydprosessoren din under **MFI HØREAPPARATER** (figur 5).
6. Trykk på navnet til brukeren eller lydprosessormodellen. Du vil se en forespørsel om paring. Trykk på «Koble til» for å starte paringsprosessen (figur 6).

   Merk: Ved paring av to lydprosessorer vil det komme to separate forespørsler om paring.
7. Apple-enheten vil pare og koble til lydprosessoren (figur 7).

   Merk: Ikke start trådløs overføring til lydprosessoren før paringen er helt fullført. Du vil høre seks pipetoner i lydprosessoren, etterfulgt av en pulstone ca. 20 sekunder senere. Du kan også vente i 120 sekunder for å være sikker på at paringen er fullført.

figur 3

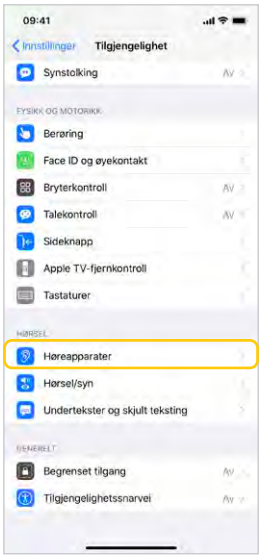

figur 4

figur 5

figur 6

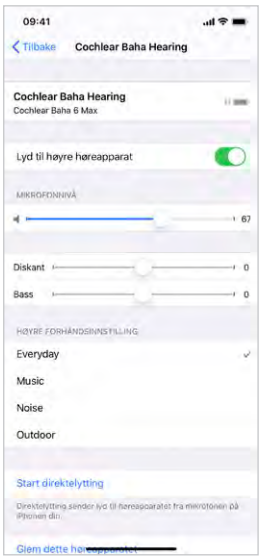

figur 7

Oppheve paring av lydprosessoren

For å fjerne en lydprosessor du har paret tidligere fra Apple-enheten, går du til **Innstillinger > Tilgjengelighet > Høreapparater** og trykker på navnet til lydprosessoren. Bla deretter ned og trykk på «Glem denne enheten».

Hurtigveiledning for MFi-tilkobling

Cochlear™ Baha® 6 Max

Betjene lydprosessoren direkte fra Apple-enheten din

Når lydprosessoren er koblet til, kan noen funksjoner styres direkte fra Apple-enheten, blant annet bytte av program, justering av lydvolum og aktivering av Live Listen™.

Med **Live Listen**-funksjonen (Direktelytting) kan mikrofonen på Apple-enheten fange opp lyd og overføre den direkte til lydprosessoren (fungerer som en ekstern mikrofon).

Kontrollere snarveien Tilgjengelighet

Snarveien Tilgjengelighet kan åpnes på flere måter, avhengig av Apple-enheten (figur 8), blant annet ved å klikke tre ganger på Home-knappen eller sideknappen, eller ved å trykke på baksiden av enheten.

For å konfigurere snarvei til Tilgjengelighet med trykking på baksiden av Apple-enheten går du til **Innstillinger > Tilhjengelighet > Berøring > Trykk på baksiden**.

Kontrollere via Settings

Gå inn på lydprosessoren via **Innstillinger > Tilgjengelighet > Høreapparater.** Trykk på navnet til lydprosessoren for å åpne flere funksjoner (figur 9).

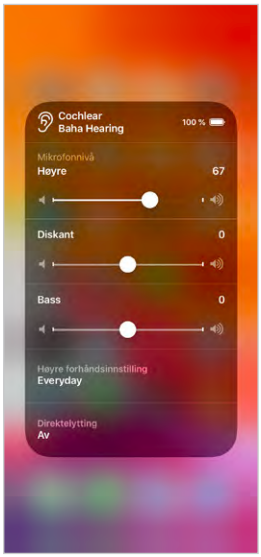

figur 8

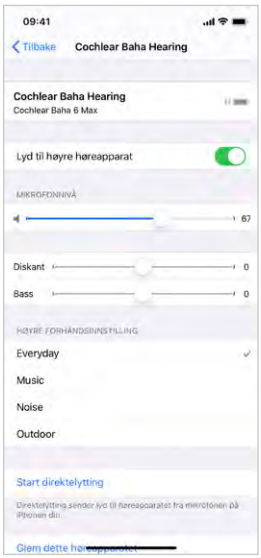

figur 9

Hurtigveiledning for MFi-tilkobling

Cochlear™ Baha® 6 Max

Overføre telefon- eller FaceTime-samtaler

Det er mulig å overføre telefon- eller FaceTime-samtaler direkte til den tilkoblede lydprosessoren.

Når lydprosessoren er koblet til, skal den være standardvalget for lydoverføring.

Når du foretar en telefonsamtale, åpnes det automatisk en meny som lar deg velge hvor lyd skal overføres (figur 10).

Når du mottar en telefonsamtale (eller under en telefonsamtale), kan du trykke på lydikonet på skjermen og velge hvor lyden skal overføres (figur 11).

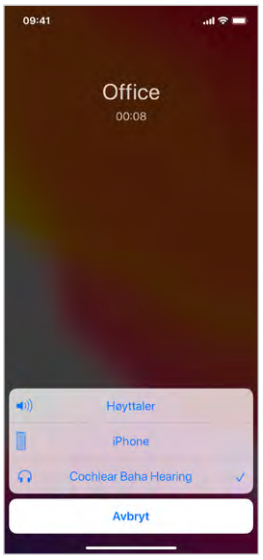

figur 10

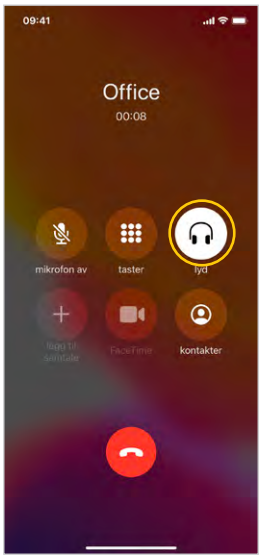

figur 11

Endre standardinnstillinger for lydoverføring

For å endre standardinnstillingene for overføring går du til **Innstillinger > Tilgjengelighet > Høreapparater**.

Hvis du ikke vil at ringetoner skal overføres til lydprosessoren, slår du av «Spill av ringetoner» (figur 12).

Hvis du ikke vil at lyd fra samtaler skal overføres til lydprosessoren, trykker du på «Lyddirigering» og deretter på «Samtalelyd» (figur 13) og velger «Aldri høreapparater».

For å slå av musikk eller annen lydoverføring (inkludert funksjonen «Live Listen») trykker du på «Medialyd» og velger «Aldri høreapparater».

figur 12

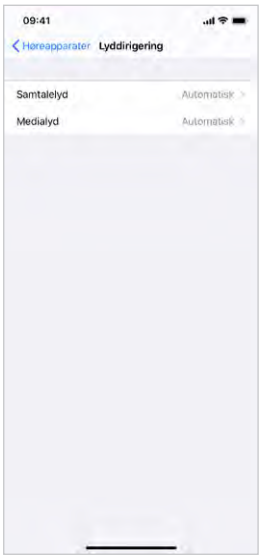

figur 13

Hurtigveiledning for MFi-tilkobling

Cochlear™ Baha® 6 Max

Paring til mer enn én Apple-enhet

Du kan pare opptil fem ulike Apple-enheter med lydprosessoren, men du kan bare være tilkoblet én lydprosessor (eller bilateralt par) om gangen.

Hjelp

Hvis du vil ha mer informasjon om og støtte for Baha 6 Max Lydprosessor og Made for iPhone-funksjonen, kan du kontakte audiografen din, se i bruksanvisningen til lydprosessoren eller gå til nettsiden til Cochlear: **www.cochlear.com**

Hvis du vil ha mer hjelp, kan du gå til www.cochlear.com/customer-service for å finne kontaktopplysningene til Cochlears kundeserviceteam i ditt område.

Cochlear Bone Anchored Solutions AB, Konstruktionsvägen 14, 435 33 Mölnlycke, Sweden
Tel: +46 31 792 44 00, Fax: +46 31 792 46 95

Regional Offices
Cochlear Ltd, (ABN 96 002 618 073), 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109 Australia
Tel: +61 2 9428 6555, Fax: +61 2 9428 6352
Cochlear Americas, 10350 Park Meadows Drive, Lone Tree, CO 80124, USA
Tel: +1 303 790 9010, Fax: +1 303 792 9025
Cochlear AG, EMEA Headquarters, Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel, Switzerland
Tel: +41 61 205 8204, Fax: +41 61 205 8205
Cochlear Latinoamerica, S. A., International Business Park Building 3835, Office 403 Panama Pacifico, Panama
Tel: +507 830 6220, Fax: +507 830 6218

www.cochlear.com

Oppsøk helsepersonell for råd om behandling for hørselstap. Resultatene kan variere, og helsepersonellet vil informere deg om de faktorer som kan påvirke resultatet som du får. Les alltid instruksjonene før bruk. Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land. Ta kontakt med din lokale Cochlear-representant for produktinformasjon. Benledningsimplantatsystemer fra Baha er i Australia ment for behandling av moderat til kraftig hørselstap.

Cochlear, Baha, 科利耳, コクレア, 코클리어, Hear now. SmartSound, den ellipseformede logoen og merker med symbolet ® eller ™ er enten varemerker eller registrerte varemerker for Cochlear Bone Anchored Solutions AB eller Cochlear Limited (med mindre annet er oppgitt).

Apple, Apple-logoen, iPhone, iPad og iPod og Facetime er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

Bluetooth®-ordet og -logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og Cochlear Limited bruker disse på lisens.

© Cochlear Bone Anchored Solutions AB 2021. Med enerett. 2021-02.

D1813798-V1. Norwegian translation of D1763078-V1.